

リストストラップテスター

MODEL: 19240取扱説明書

文書番号 TBJ-3017

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

SECTION 1

梱包内容

	内 容	
数量		
1.	19240本体	1台
2.	マジックテープ	1組
3.	006P型 9V 角型電池	1個
4.	校正証明書	1部
5.	説明書(本紙)	1部

外観

19240本体



SECTION 2

仕様

19240リストストラップテスターは006P型 9V 角型電池で作動し、作業者からリストストラップを通しての抵抗値を判定する装置です。


判定基準は下記の通りです。

抵抗値	結果表示など
750k Ω 以下	LOWライト点灯、アラーム音
750k Ω ～10M Ω	PASSライト点灯
10M Ω 以上	HIGHライト点灯、アラーム音

SECTION 3

使用方法

被測定者のリストストラップのバナナ端子側をリストストラップテスターに差込み、被測定者が測定開始ボタンを押します。乾燥状態もしくは乾燥肌の被測定者の場合、HIGHの結果が出る場合がありますので、その場合はローションなどで肌を加湿することをお勧めします。LOW Battのライトは電池電圧が正常な場合は点滅します、点灯状態が続く場合はバッテリー電圧が低いことを示していますので早めに交換してください。

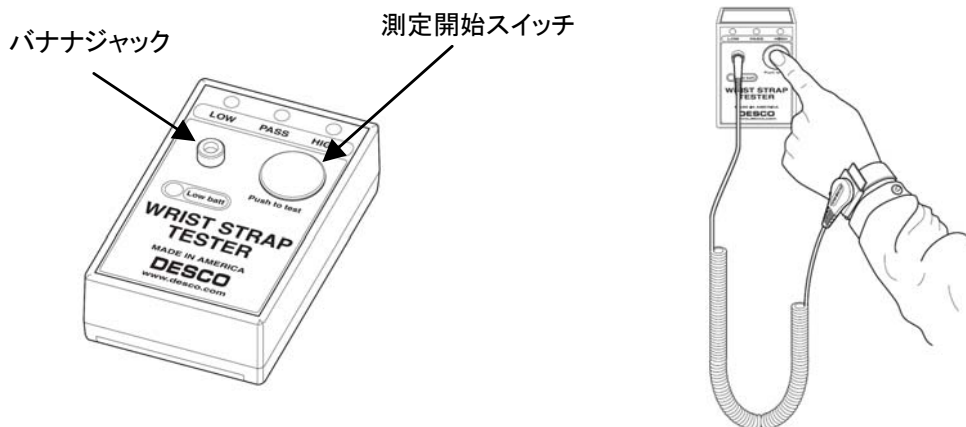

SECTION 4

校正

年一回の校正を行い、判定結果が正しいかどうかの確認をお願いします。校正方法はバナナ端子と測定開始ボタンの間に抵抗を入れ、下記の結果が得られれば正常に作動していると言えます。もし正常に作動していない場合は弊社に返却願います。

抵抗値 (±1%以下)	結果
750kΩ	LOWライト点灯、アラーム音
850kΩ	PASS
9MΩ	PASS
11MΩ	HIGHライト点灯、アラーム音

注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ等お気づきの事がありましたら、ご連絡下さい。

保証規定

- ・ 本製品は、米国 DESCO Industries Inc. 社により製造され、日本国内の販売、保守、サービスは、DESCO JAPAN 株式会社が担当するものです。
- ・ 本製品が万一故障した場合は、製品購入後一年以内については無料で修理調整を行います。ただし、以下の項目に該当する場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
 - ・ (1) 取扱説明書以外の誤操作、悪用、不注意によって生じた故障。
 - ・ (2) 当社以外で行われた修理、改造等による故障。
 - ・ (3) 火災、天災、地変等による故障。
 - ・ (4) 使用環境、メンテナンスの不備による故障。
- ・ 保証の対象となるのは、本体で付属品、部品等の消耗は、保証の対象とはなりません。
- ・ * 本保証は、上記保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・ * 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。

機器に明らかなる不良がある場合については、下記内容を当社にご連絡下さい。

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) 機種名または、品番 | 4) ご購入年月日 |
| 2) 製品シリアルナンバー | 5) 御社名、部署名、担当者名 |
| 3) 不良内容(できるだけ具体的に) | 6) 連絡先 |

以上の内容を検討致し返却取扱ナンバーを御社に連絡致します。製品を返却する場合は、返却取扱ナンバーを製品に添付してご返却下さい。

返却ナンバーが表示されていない場合は、保証の対象とならない場合があります。

DESCO ASIA

DESCO JAPAN 株式会社

〒289-1115

千葉県八街市八街ほ 20-2

Tel: 043-309-4470 Fax: 043-309-4471

<http://www.descoasia.co.jp/>

2011-05 REV.2